




รายละเอียดเงื่อนไขประกอบการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. คุณสมบัติเฉพาะ

- ๑.๑ ผู้รับจ้างจะต้องดูแลเครื่องไตเทียมของโรงพยาบาลที่มีอยู่ให้พร้อมใช้เสมอหรือจะต้องมีเครื่องไตเทียมสำรองพร้อมใช้งานสำหรับให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแก่ผู้ป่วย ณ หน่วยบริการไม่น้อยกว่า ๘ เครื่องและเครื่องสำรองจะต้องเป็นเครื่องใหม่พร้อมใช้งานอายุเครื่องไม่เกิน ๑ ปี
- ๑.๒ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบดูแลสถานที่ให้บริการ ณ อาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (อาคารหลวงลำปาง) ชั้น ๒ โรงพยาบาลเกาะคา และผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยให้มีความสวยงาม สะอาด สะอาด ปลอดภัย ถูกต้องตามมาตรฐานสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
- ๑.๓ ผู้รับจ้างต้องดูแลระบบงานไตเทียม ดังนี้
 - ๑.๓.๑ ดูแลระบบน้ำบริสุทธิ์รีเวอร์สออสโมซิสขนาดไม่ต่ำกว่า ๘๐๐ ลิตร/ชั่วโมง โดยคุณภาพน้ำบริสุทธิ์ที่ผลิตได้จะเป็นตามมาตรฐาน AAMI และกำหนดให้ใช้ระบบน้ำโรคไตแห่งประเทศไทย ตามมาตรฐานดังนี้
 - ๑.๓.๑.๑ ส่วนประกอบของระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์
 - ๑.๓.๑.๑.๑ ต้องมีชุด pre - treatment ซึ่งประกอบด้วย Particle filter, Softener และ carbon filter
 - ๑.๓.๑.๑.๒ ต้องมีชุด carbon filter ในลักษณะสองถังวางต่อกันแบบอนุกรม
 - ๑.๓.๑.๑.๓ ต้องมีชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์เป็นระบบ Reverse osmosis
 - ๑.๓.๑.๑.๔ ต้องมี Pre - RO filter ขนาดไม่ใหญ่กว่า ๕ ไมครอน
 - ๑.๓.๑.๒ ส่วนประกอบของระบบจ่ายน้ำบริสุทธิ์
 - ๑.๓.๑.๒.๑ ระบบจ่ายน้ำต้องเป็นชนิดไหลวนกลับ (recirculation loop)
 - ๑.๓.๑.๒.๒ ถ้ามีถังเก็บน้ำบริสุทธิ์ ต้องมีระบบป้องกันการก่อตัวหรือการแพร่กระจายเชื้อโรคในระบบจ่ายน้ำบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลา โดยการใช้ Filter ขนาด ๐.๒ ไมครอน และ UV light
 - ๑.๓.๑.๒.๓ ถังเก็บน้ำบริสุทธิ์และท่อส่งน้ำบริสุทธิ์ต้องผลิตจากวัสดุไม่เกิดสนิม
 - ๑.๓.๑.๒.๔ ต้องมีเครื่องวัดความบริสุทธิ์ของน้ำ (Conductivity meter หรือ Resistivity Meter หรือ TDS meter) ชนิด on -line ในระบบจ่ายน้ำหรือในระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์
 - ๑.๓.๑.๓ การบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์
 - ๑.๓.๑.๓.๑ ต้องมีการตรวจคุณภาพของชุด pre - treatment เป็นประจำอย่างน้อยต้องตรวจหาปริมาณคลอรีนในน้ำที่ไหลผ่านออกจาก carbon filter ถึงแรกอย่างน้อยทุก ๑ สัปดาห์

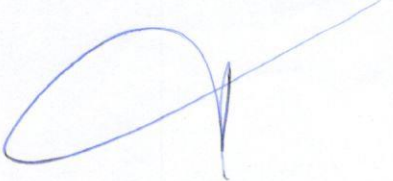

นายรัฐพล เกียรติยศนุสรณ์
ประธานกรรมการ



นายปิยะวัฒน์ ศรีคงมาก
กรรมการ



นางธันวมาศ ชัยเชียร
กรรมการ




- ๑.๓.๑.๓.๒ ต้องมีการตรวจสอบความกระด้างของน้ำที่ไหลผ่านออกจากชุด softener เป็นประจำ อย่าง น้อยทุก ๑ สัปดาห์ และต้องมีการ regenerate สารกรองชุดลดความกระด้างเป็นระยะ
- ๑.๓.๑.๓.๓ ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของชุด RO เป็นประจำทุกวัน
- ๑.๓.๑.๑.๔ การบำรุงรักษาระบบการจ่ายน้ำบริสุทธิ์
 - ๑.๓.๑.๑.๔.๑ ต้องมีการอบฆ่าเชื้อในระบบจ่ายน้ำบริสุทธิ์อย่างน้อยทุก ๖ เดือน ด้วยวิธีที่เหมาะสมและต้องทำก่อนกำหนด เมื่อผลการเพาะเชื้อ น้ำตัวอย่างจากระบบจ่ายน้ำบริสุทธิ์พบแบคทีเรียมากกว่า ๑๐๐ cfu/ml.
 - ๑.๓.๑.๑.๔.๒ ต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามระยะเวลา เช่น bacteria filter, หลอดไฟ UV, air filter
- ๑.๓.๑.๑.๕ การตรวจคุณภาพน้ำบริสุทธิ์ โดยต้องมีการเก็บตัวอย่างน้ำบริสุทธิ์จากตำแหน่ง ได้แก่
 - ๑.๓.๑.๑.๕.๑ ตำแหน่งต้นทางของระบบจ่ายน้ำบริสุทธิ์
 - ๑.๓.๑.๑.๕.๒ ปลายทางของระบบจ่ายน้ำบริสุทธิ์
 - ๑.๓.๑.๑.๕.๓ ตำแหน่งที่ใช้ล้างและเตรียมตัวกรองเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำส่งเพาะเชื้อ เป็นประจำทุกเดือน
 - ๑.๓.๑.๑.๕.๔ ต้องมีการเก็บตัวอย่างน้ำบริสุทธิ์จากตำแหน่งของน้ำ dialysate ของเครื่องไตเทียมแต่ละเครื่อง อย่างน้อย ๒ เครื่องต่อเดือน หมุนเวียนกันจนครบทุกเครื่องในเวลาที่กำหนดส่งเพาะเชื้อเป็นประจำทุกเดือน
 - ๑.๓.๑.๑.๕.๕ ต้องมีการส่งน้ำบริสุทธิ์ตรวจหาสารปนเปื้อนทางเคมีตามมาตรฐาน ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
- ๑.๓.๒ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น พร้อมให้บริการ ดังนี้
 - ๑.๓.๒.๑ เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG Monitoring) ระหว่างฟอกเลือดอย่างน้อยจำนวน ๑ เครื่อง
 - ๑.๓.๒.๒ เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG ๑๒ lead) อย่างน้อยจำนวน ๑ เครื่อง
 - ๑.๓.๒.๓ เครื่องกระตุกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Defibrillator) อย่างน้อยจำนวน ๑ เครื่อง
 - ๑.๓.๒.๔ Set อุปกรณ์ช่วยกู้ฟื้นคืนชีพ ดังนี้ Ambu Set, กระดานรองหลัง ๑ แผ่น, ชุดอุปกรณ์ Suction พร้อมสาย, ยาที่จำเป็นในการช่วยกู้ฟื้นคืนชีพ, ชุดให้ Oxygen พร้อมสาย อย่างน้อยจำนวนละ ๒ ชุด
 - ๑.๓.๒.๕ เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด พร้อมแผ่นตรวจ (Strip)
 - ๑.๓.๒.๖ เครื่องตรวจวัดค่า Oxygen ในเลือด (Pulse Oxymeter)
 - ๑.๓.๒.๗ เครื่องให้สารน้ำ, ยาทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump)
 - ๑.๓.๒.๘ เครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่



นายรัฐพล เกียรติยศสุนทรณ์
ประธานกรรมการ



นายปิยะวัฒน์ ศรีคงมาก
กรรมการ



นางธันวมาศ ชัยเจียร
กรรมการ



- ๑.๓.๒.๙ เครื่องล้างตัวกรองแบบอัตโนมัติชนิดสองช่องล้างหนึ่งเครื่อง
- ๑.๓.๒.๑๐ ก๊าซออกซิเจน และชุดให้/พ้นออกซิเจนพร้อมใช้งานให้อย่างน้อย ๘จุดแบบติดผนัง
- ๑.๓.๓ ดูแลและจัดหาวัสดุสำนักงานให้พร้อมใช้งาน ดังนี้
- ๑.๓.๓.๑ Nurse Station และเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่
- ๑.๓.๓.๒ เก้าอี้นั่งพักสำหรับผู้ป่วยและญาติ
- ๑.๓.๓.๓ เก้าอี้ปรับเอนได้สำหรับผู้ป่วยพอกเลือด ไม่น้อยกว่า ๘ ตัว
- ๑.๓.๓.๔ โทรศัพท์ไร้สาย ๒ เครื่อง
- ๑.๓.๓.๕ โทรศัพท์ สำหรับญาติผู้ป่วย
- ๑.๓.๓.๖ ตู้เย็นขนาด ๕.๕ คิว จำนวน ๑ เครื่อง
- ๑.๓.๓.๗ เครื่องปรับอากาศ จำนวนเครื่องเหมาะสมพื้นที่ในหน่วยบริการ
- ๑.๓.๓.๘ เครื่องคอมพิวเตอร์ Hard Ware จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับบันทึก - ส่งข้อมูลผู้ป่วยในการเบิกค่ารักษาพยาบาลจาก สกส. และติดตั้งระบบ LAN ลงข้อมูลผู้ป่วย
- ๑.๓.๓.๙ รถเข็นสำหรับทำการพยาบาล ๒ ชุด
- ๑.๓.๓.๑๐ รถเข็นช่วยผู้ป่วยขึ้นลิฟ (Emergency Cart)
- ๑.๓.๓.๑๑ ถังขยะแยกตามประเภท เช่น ขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ พร้อมล้อขนขยะ
- ๑.๓.๔ จัดหาวัสดุการแพทย์ที่ใช้ในการพอกเลือด ดังนี้
- ๑.๓.๔.๑ น้ำยาไตเทียม ชนิด A (Part A) และชนิด B (Part B) โดยชนิด A ตามความเหมาะสมในข้อบ่งใช้ (A ธรรมดา , A low calcium , AK^m , A low calcium +K^m , AK^c)
- ๑.๓.๔.๒ การใช้ตัวกรองเลือดที่มีประสิทธิภาพสูง (High flux) ผู้ป่วยไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากการใช้ตัวกรองเลือดที่มีประสิทธิภาพสูง
- ๑.๓.๔.๓ ตัวกรองเลือดที่ใช้ในการพอกเลือด (Dialyzer) ชนิด Low Flux ใช้ซ้ำได้ไม่เกิน ๑๕ ครั้ง และ High Flux ควรใช้ซ้ำได้ไม่เกิน ๒๐ ครั้ง
- ๑.๓.๔.๔ ชุดสายส่งเลือด (Blood Line) พร้อม Set IV. Transducer Protector ใช้ครั้งเดียว
- ๑.๓.๔.๕ เข็ม AVF ชนิดปลายแหลม No.๑๕” , ๑๖” , ๑๗” และเข็ม AVF ชนิด ปลายทู่ (Button hole) No.๑๕” , ๑๖”
- ๑.๓.๔.๖ สารป้องกันการแข็งตัวของเลือด (Heparin)
- ๑.๓.๔.๗ น้ำยาฆ่าเชื้อ ๕% Sodium Hypochlorite , ๓.๒๕-๔% Peracetic acid mixture , ๓๐% Citric acid , ๗๐% Alcohol , Formalin , Chlorhexidine Paint , Providine Paint
- ๑.๓.๔.๘ Set ทำหัตถการต่าง ๆ เช่น Dressing Set , Insert DLC , Set Suture Set (รวมอุปกรณ์สำลี , ผ้าก๊อซ , ผ้า Sterile , ผ้ารอง)
- ๑.๓.๔.๙ น้ำยาทำความสะอาดมือ เช่น Hibi Scrub , Alcohol Hard rub
- ๑.๓.๔.๑๐ น้ำเกลือ ชนิด NSS ๑,๐๐๐ , ๕๐๐ c.c
- ๑.๓.๔.๑๑ ถุงมือ Sterile , disposable No.๖,๗,๗.๕


นายรัฐพล เกียรติยศสุนทรณ์
ประธานกรรมการ


นายปิยะวัฒน์ ศรีคงมาก
กรรมการ


นางธันวมาศ ชัยเจียร
กรรมการ

๑.๓.๔.๑๒ Syringe ๕๐, ๒๐, ๑๐, ๕, ๓ c.c. ตามลำดับ

๑.๓.๔.๑๒ เข็ม No.๑๘, ๒๒, ๒๔

๑.๔ การบริหารจัดการยา Erythropoiesis Stimulating agents (ESA) ทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้ดำเนินการ

๑.๕ ในกรณีที่เครื่องไตเทียมชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ ทางผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องไตเทียมใหม่พร้อมใช้งานมาทดแทน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ในกรณีที่ผู้ป่วย online HDF ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

๑.๖ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการบริการดูแลระบบน้ำ, ระบบไฟฟ้าและเครื่องไตเทียม ทั้งค่าบำรุงรักษาและอะไหล่ชำรุดเสียหายตลอดการใช้งาน

๑.๗ ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากเครื่องไตเทียมเบื้องต้น ก่อนที่จะปล่อยน้ำเสียลงสู่บ่อบำบัดหลักของโรงพยาบาลโดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ให้เป็นไปตามแบบที่โรงพยาบาลกำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันหลังจากทำสัญญา

๑.๘ ผู้รับจ้างต้องจัดหาแพทย์เฉพาะทางโรคไต (Nephrologist) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ คน เป็นที่ปรึกษา รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยที่หน่วยบริการ และเข้าร่วมตรวจรักษาผู้ป่วยฟอกเลือดทุกคน อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑-๒ ครั้งและให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่มีอาการคงที่


๑.๙ ผู้รับจ้างต้องจัดหาพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมไตเทียม หลักสูตร ๔ เดือน จำนวน ๑ คน และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียมไม่น้อยกว่า ๒ คนต่อรอบ ซึ่งสามารถเป็นตัวแทนประสานงานกับผู้ว่าจ้าง และดูแลหน่วยบริการซึ่งอยู่ภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาล (HA) พร้อมทั้งดูแลด้านการพยาบาล และดูแลหน่วยบริการซึ่งอยู่ภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาล (HA) พร้อมทั้งดูแลด้านการพยาบาล ลงบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาในระบบโปรแกรมหลักของโรงพยาบาล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โปรแกรม TRT Online ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ และต้องเก็บรวบรวมและรายงานผลตามตัวชี้วัดคุณภาพบริการฟอกเลือดตามมาตรฐานให้แก่โรงพยาบาลทุก ๖ เดือน


๑.๑๐ ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าฟอกเลือดในโปรแกรม ตามสิทธิการรักษา กรณีผู้รับบริการไม่มีสิทธิการรักษาใด ๆ ที่ต้องชำระเงินค่าฟอกเลือดเอง ให้ผู้รับบริการไปยื่นชำระเงินที่ห้องการเงินของโรงพยาบาล ผู้รับจ้างจัดหาพนักงานสนับสนุนบริการ ดังนี้ ผู้ช่วยเหลือคนไข้, พนักงานทำความสะอาด โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด


๑.๑๑ กรณีมีการให้บริการฟอกเลือดแบบออนไลน์ (HDF) ให้ผู้รับจ้างเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ป่วยคืนจากผู้ว่าจ้างจำนวน ๒๐๐ บาท และออกใบเสร็จให้ผู้ป่วยทุกครั้ง


๑.๑๒ กรณีมีการใช้ตัวกรองเลือดอันใหม่ในผู้ป่วยที่มาฟอกไตแบบชั่วคราวให้ผู้รับจ้างเบิกค่าเปิดตัวกรองเลือดใหม่คืนจากผู้ว่าจ้างจำนวน ๕๐๐ บาทต่อตัวกรอง ๑ อันโดยผู้รับจ้างต้องบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนในระบบโปรแกรม Hos -xp ของทางโรงพยาบาล

๑.๑๓ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในส่วนค่าตอบแทนของแพทย์, พยาบาล, พนักงานสนับสนุนบริการในหน่วยบริการเอง



นายรัฐพล เกียรติยศคุณสรณ์
ประธานกรรมการ



นายปิยะวัฒน์ ศรีคงมาก
กรรมการ



นางธันวมาศ ชัยเกียรติ
กรรมการ



- ๑.๑๔ กรณีไม่มีพนักงานสนับสนุนบริการมาปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไม่ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดส่งพนักงานดังกล่าวมาปฏิบัติงานในครบตามที่กำหนดไว้
- ๑.๑๕ ในการทำงานจ้างของผู้รับจ้าง ถ้าเกิดความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแก่บุคลากรของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอก หรือเกิดความชำรุดบกพร่องเสียหายหรือการสูญหายแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือของบุคลากรผู้ว่าจ้างหรือของบุคลากรภายนอกอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำของผู้รับจ้าง พนักงานหรือบุคลากรของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอกตามจำนวนที่เสียหายจริงภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
- ๑.๑๖ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเองหรือพนักงานของผู้รับจ้างทำงานจ้างบกพร่อง โดยทำไว้มิเรียบร้อยก็ดี ใช้วัสดุอุปกรณ์หรือน้ำยาที่ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานหรือคุณภาพไม่ดี หรือทำไม่ถูกต้องตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี เมื่อผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยโดยเร็ว โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้ว่าจ้าง ถ้าผู้รับจ้างไม่รีบดำเนินการแก้ไขหรือไม่ปฏิบัติภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างทั้งหมดโดยสิ้นเชิง
- ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญาดังกล่าวข้างต้น และผู้ว่าจ้างยังมิใช้สิทธิบอกเลิกผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการ ดังนี้
- ๑.๑๖.๑ ระงับการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร
- ๑.๑๖.๒ ยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของวงเงินตามรอบการจ่ายแต่ละครั้ง โดยใช้วงเงินรวมที่ผู้ว่าจ้างจ่ายสูงสุดที่ผ่านมา นับแต่วันที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้แก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยตามสัญญา หรือวันที่บอกเลิกสัญญา ในเมื่อผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
- ๑.๑๖.๓ การเรียกค่าเสียหายใดๆ อันพึงมี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักเงินค่าจ้างที่ยังไม่ได้จ่ายแก่ผู้รับจ้างไว้เพื่อชำระค่าปรับ หรือค่าเสียหายที่ผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ แต่ถ้าจำนวนเงินค่าจ้างไม่เพียงพอให้หักชำระหนี้ ผู้รับจ้างยินยอมให้หักจากเงินหลักประกันสัญญาได้ทันทีอีกด้วย
- ๑.๑๗ ผู้รับจ้างจะเองงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งสัญญาไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงจะกระทำไม่ได้ ผู้รับจ้างจะต้องขออนุญาตจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา หากในกรณีที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ว่าจ้างอนุญาตให้ผู้รับจ้างดำเนินการจ้างช่วง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบงานที่ได้จ้างช่วงนั้นไปทุกประการ
- ๑.๑๘ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหลักประกันสัญญาตามสัญญาทั้งหมด และผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะจ้างผู้อื่นทำงานต่อไปได้ โดยผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกเอาค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะการจ้างบุคคลอื่นทำกรานนี้ไปจนงานแล้วเสร็จบริบูรณ์จากผู้รับจ้าง นอกจากนั้นผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายประการอื่นใดอันพึงมีขึ้นจากการผิดสัญญาของผู้รับจ้างได้อีกด้วย
- ๑.๑๙ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้าง ก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้รับใบแจ้งผลผ่านการประเมินจากคณะกรรมการการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม(ตรต.) มาแสดงต่อผู้ว่าจ้างแล้วเท่านั้นและตกลงชำระค่าจ้างภายใน ๓๐ วัน หลังจากผู้รับจ้างส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บ


นายรัฐพล เกียรติยศบุตรณี
ประธานกรรมการ


นายปิยะวัฒน์ ศรีคงมาก
กรรมการ


นางธันวมาศ ชัยเอียร
กรรมการ


- ๑.๒๐ ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตามมาตรฐานของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยฉบับปรับปรุงล่าสุดในทุกด้าน และรับผิดชอบจัดการ รวมทั้งจ่ายค่าตรวจรับรองมาตรฐานดังกล่าวทุกครั้ง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันหลังจากทำสัญญา
- ๑.๒๑ เมื่อครบกำหนดสัญญา หรือเมื่อสัญญาจะงบลงไปด้วยกรณีใด ๆ ผู้รับจ้างต้องยอมออกจากพื้นที่ และดำเนินการขนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่ ที่ใช้อยู่ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่สัญญาจะงบลงและได้รับแจ้งจากทางผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร หากไม่ดำเนินการดังกล่าวผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ขนย้ายสิ่งของที่ไม่ใช่และเข้าครอบครองสิ่งของในพื้นที่ดังกล่าวได้ทันที โดยผู้รับจ้างจะไม่ร้องทุกข์และดำเนินคดีใด ๆ ทั้งสิ้นกับผู้ว่าจ้าง
- ๑.๒๒ หากมีผู้รับจ้างใหม่ต้องสามารถติดตั้งระบบดังกล่าวทั้งหมดตรงตามมาตรฐานของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และจัดการผ่านมาตรฐานการรับรองจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย จนสิ้นสุดกระบวนการและสามารถเปิดดำเนินการให้บริการดังกล่าวได้จริงภายในระยะเวลา ๑ เดือนและผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด


๒. สถานที่ในการดำเนินการ


หน่วยไตเทียม ชั้น ๒ อาคารหลวงลำปาง โรงพยาบาลเกาะคา

๓. วงเงินในการจัดจ้าง

การจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลเกาะคา ราคา ๑,๓๕๐ บาทต่อรอบ
ในวงเงิน ๔,๒๗๐,๐๘๐.-บาท (สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดสิบบาทถ้วน)


นายรัฐพล เกียรติยศนุสรณ์
ประธานกรรมการ


นายปิยะวัฒน์ ศรีคงมาก
กรรมการ


นางธันวาคม ชัยเชียร
กรรมการ

